

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от « 09 » апреля 2013г. № 373 .

**Перечень государственных эталонов единиц величин,
содержащихся и применяемых Федеральным бюджетным учреждением
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области»
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Юридический/почтовый адрес : 400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 6
ИНН : 3443013406

№ п/п	Наименование эталона	Регистрационный номер эталона	Межатгестацион- ный интервал (месяцы)	Примеча- ние
1	2	3	4	5
1.	Государственный эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне значений от 0 до 660 °С	3.1.ЗБИ.0001.2012	24	
2.	Государственный эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне значений от -196 до 0,01 °С	3.1.ЗБИ.0002.2012	24	
3.	Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от -50 до 450 °С	3.1.ЗБИ.0003.2012	12	
4.	Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от -50 до 450 °С	3.1.ЗБИ.0004.2012	12	
5.	Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от -200 до 420 °С	3.1.ЗБИ.0005.2012	24	


1	2	3	4	5
6.	Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от -200 до 420 °С	3.1.ЗБИ.0006.2012	24	
7.	Государственный эталон шкалы рН 2 разряда в диапазоне значений от -1 до 14 рН	3.1.ЗБИ.0007.2012	12	
8.	Государственный эталон единицы массовой концентрации компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 40 до 2000 мг/м ³	3.1.ЗБИ.0008.2012	12	
9.	Государственный эталон единицы массовой концентрации компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 40 до 2000 мг/м ³	3.1.ЗБИ.0009.2012	12	
10.	Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от -20 до 150 °С	3.1.ЗБИ.0010.2012	24	
11.	Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 300 до 1100 °С	3.1.ЗБИ.0011.2012	24	
12.	Государственный эталон единицы давления для разности давлений 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 400 кгс/м ²	3.1.ЗБИ.0012.2012	24	
13.	Государственный эталон единицы влажности газов 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 95 % относительной влажности	3.1.ЗБИ.0013.2012	12	

И.о. начальника Управления метрологии

Начальник Управления территориальных органов и региональных программ



С.С. Голубев

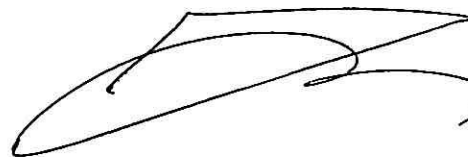

Д.А. Черничкин